


古いレコーダを置き換えよう！ 圧力機器 検査での圧力測定


置換シリーズ
第6弾！

【業種】
検査

使用例 → 圧力機器の検査データを記録紙に出力しながら、収録します

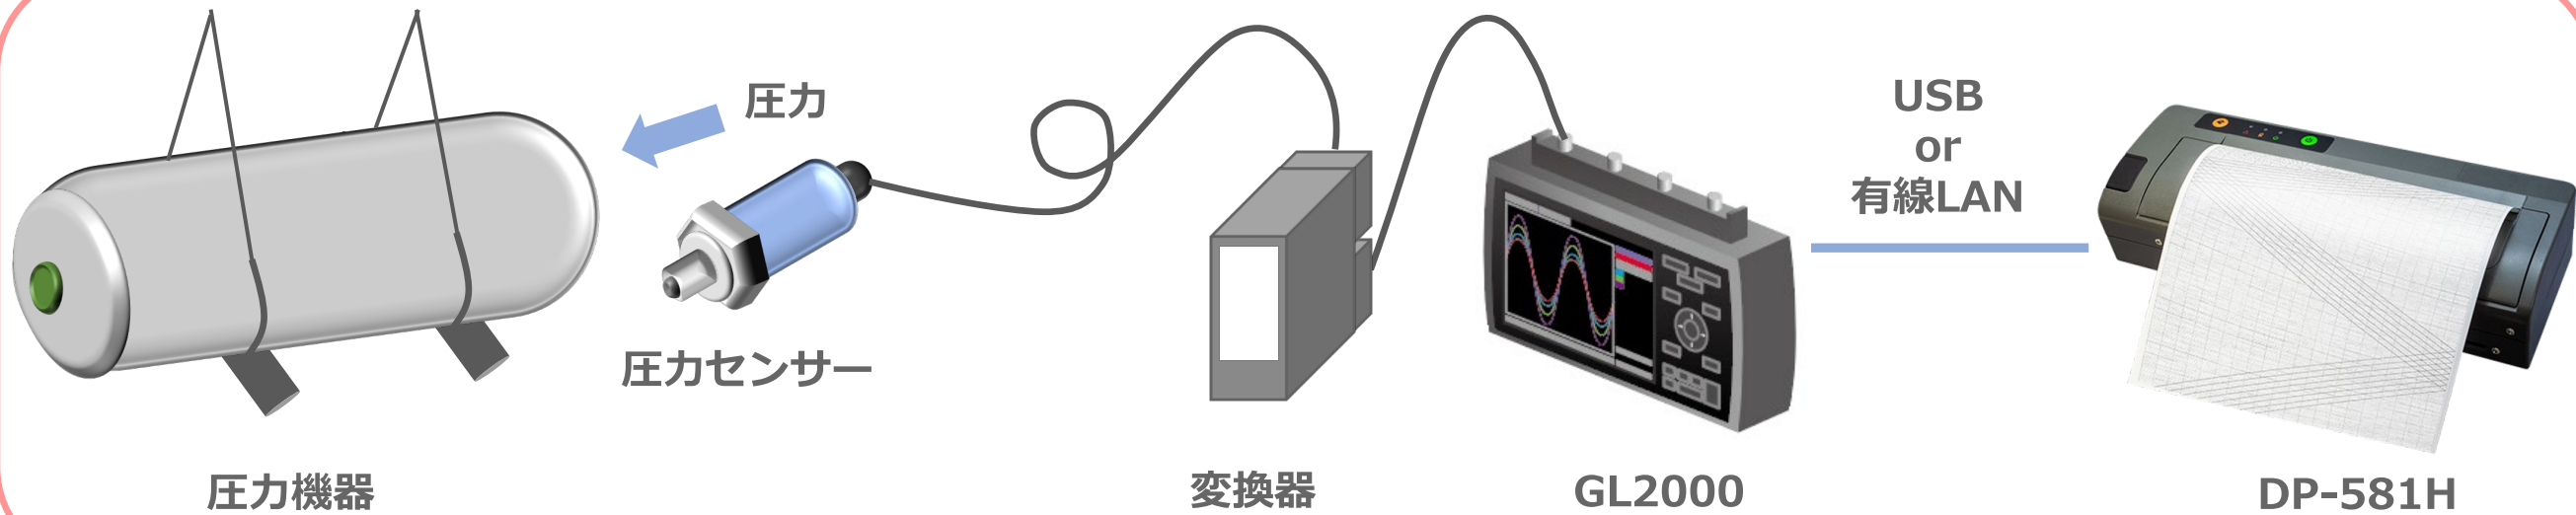

古いレコーダ
をお使いでは
ありませんか？



▲WX1200 ▼WR300



GLとサーマル
プリンタに
置換！



サーマルプリンタ
DP-581H

絶縁高速8ch口ガー
GL980



¥561,000(税込)

高電圧高速4ch口ガー
GL2000



¥418,000(税込)

■お問い合わせは下記へ

Ai Holdings Group

グラフテック株式会社

本社 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

東日本担当 ☎(045)825-6217

北海道全域・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島・新潟
長野・茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨

中部担当 ☎(052)937-2533

静岡・愛知・三重・岐阜

詳しい商品情報はこちら
www.graphtec.co.jp



西日本担当 ☎(06)6821-8821

大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山
兵庫・富山・石川・福井・四国全域

福岡担当 ☎(092)451-0505

岡山・広島・島根・鳥取・山口・福岡・佐賀
大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄